



Order #: COKAL2410AS


Lait

Selon la directive européenne 2007/68/CE la présence de lait de vache doit être étiquetée. Environ 80% des protéines du lait de vache sont les caséines. La β -lactoglobuline, l'allergène majeur du lactosérum, représente encore 10% de la protéine totale. Le lait de vache est l'un des plus importants ingrédients alimentaires allergisants notamment pour les enfants de moins de trois ans.

Protocole simplifié



Réaliser l'extraction pour les produits finis, les eaux de rinçage et des écouvillons.




Transférer **12 Gouttes** d'extrait dans un tube: "incubation Vial" .



Agiter manuellement et vigoureusement le tube pendant **15 secondes**.



Incuber pendant **5 minutes** à température ambiante.



Insérer la bandelette dans le tube et incuber **pendant 5 minutes**.
Lire le résultat immédiatement.

Résumé des performances:


LDD: 1 ppm protéines du lait * (Pour produits finis et eaux de rinçage)
1 $\mu\text{g}/25\text{cm}^2$ protéines du lait ** (Ecouvillonnage)

* LDD a été déterminé sur la solution d'extraction.

** LDD été calculée

Préparation des échantillons – Produits finis et eaux de rinçage

1. Homogenizer l'échantillon (i.e. blender, broyeur, grinder)




2. Ajouter **0,2 ml** d'eau de rinçage ou **0,2g** d'échantillons (peser ou estimer la quantité en remplissant le capuchon du tube d'extraction) dans le tube d'extraction : « extraction tube ».




or




3. Compléter le tube avec le tampon d'extraction: "**extraction buffer**" jusqu'au col du tube (voir flèche bleue)



4. Fermer le tube avec le bouchon puis homogénéiser manuellement et vigoureusement pendant **1 minute**.




5. Remplacer le bouchon du tube d'extraction par le bouchon compte-gouttes. Ajouter **12 gouttes (ou 400µl)** dans le tube incubation : « incubation vial ».



Reportez-vous à la section Essai page 3 pour finir votre test

Préparation des échantillons – Ecouvillonnage

1. Compléter le tube avec le tampon d'extraction: "**extraction buffer**" jusqu'au col du tube (voir flèche bleue) puis humidifier l'embout de l'écouvillon avec le tampon d'extraction.




2. Ecouvillonner par rotation une surface de **5cmx5cm** suivant le protocole ci-dessous.





3. Placer l'écouvillon dans le tube puis casser la tête de l'écouvillon suivant la zone prédécoupée.



4. Fermer le tube avec le bouchon puis homogénéiser manuellement et vigoureusement pendant **1 minute**



5. Remplacer le bouchon du tube d'extraction par le bouchon compte-gouttes. Ajouter **12 gouttes (ou 400µl)** dans le tube incubation : « incubation vial »




Reportez-vous à la section Essai page 3 pour finir votre test

Section Essai: mode d'emploi détaillé

1. Agiter manuellement et vigoureusement pendant **15 secondes** (assurez-vous que le liquide soit en contact avec le bouchon du tube) puis incuber **5 minutes** à température ambiante.




2. Sortir le nombre nécessaire de bandelettes puis insérer la bandelette dans le tube d'incubation: "incubation Vial"

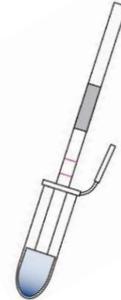

3. Retirer la bandelette du tube d'incubation **après incubation de 5 minutes**. Lire immédiatement la bandelette.

Interpretation des résultats

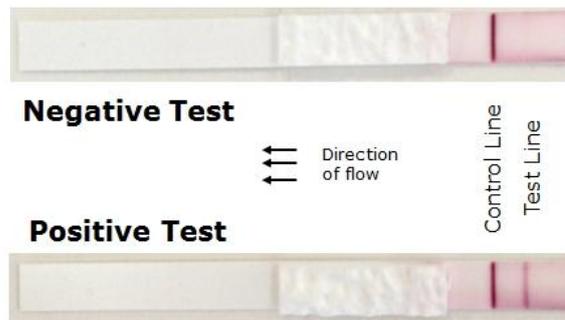

Une ligne mauve dans la zone de lecture: résultat négatif inf au seuil de détection

Deux lignes mauves dans la zone de lecture: résultat positif. L'échantillon contient une concentration d'allergènes supérieure au seuil de détection. Une confirmation peut être envisagée par méthode ELISA quantitative.

Aucune ligne n'apparaît: résultats non validés. Dans ce cas, nous vous recommandons de réaliser le test à nouveau avec une nouvelle bandelette. Si les résultats sont de nouveau invalidés, nous vous remercions de contacter votre interlocuteur local Romer Labs.

Recommandations importantes avant la réalisation du test

- Nous vous recommandons de lire la bandelette immédiatement après l'étape d'incubation de 5 minutes. L'augmentation du temps d'incubation avant l'interprétation du test peut entraîner un risque de résultat faussement positif.
 - La gamme AgraStrip allergens a été développée pour la détection de trace d'allergènes. Dans le cas d'échantillons contenant de trop grande quantité (10000ppm), le test peut induire une réaction faussement négative.
-






Détails des caractéristiques et performances

Limite de détection: 1 ppm protéines du lait (Produit finis & eaux de rinçage)
1 µg/25cm² protéines du lait (écrivonnage)

Gamme de détection: 1 – 10000 ppm protéines du lait

Gamme de pH: Réaliser le test à partir d'un extrait ayant un Ph compris entre 6 et 8. Les extraits très acides peuvent induire des résultats faussement positifs. Les extraits très alcalins peuvent induire des résultats faussement négatifs.

Matériels nécessaire fournis dans le kit:

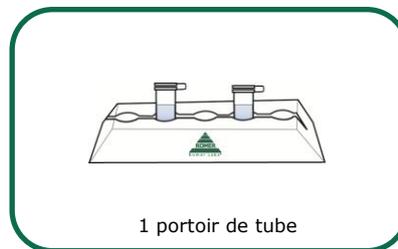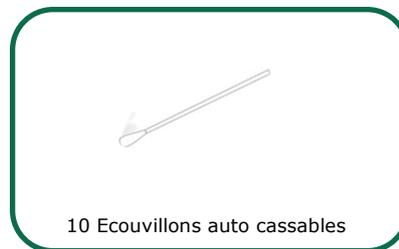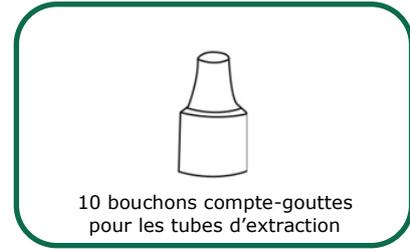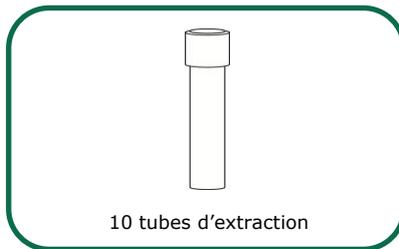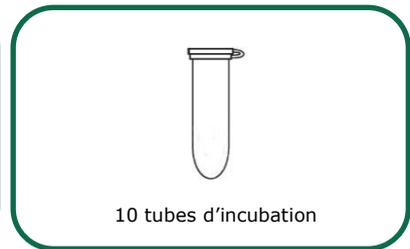

Matériels nécessaire mais non fournis dans le kit

- Blender ou Broyeur ou grinder

Informations techniques

Le kit bandelette AgraStrip® Milk est un test à flux latéral pour la détection du lait présente dans les aliments, les eaux de rinçage ou des échantillons d'échantillonnage environnementaux.

L'Allergie au lait

Selon la directive européenne 2007/68/CE la présence de lait de vache doit être étiquetée. Environ 80% des protéines du lait de vache sont les caséines. La β -lactoglobuline, l'allergène majeur du lactosérum, représente encore 10% de la protéine totale. Le lait de vache est l'un des plus importants ingrédients alimentaires allergisants notamment pour les enfants de moins de trois ans. De très faibles quantités de lait de vache peuvent provoquer des réactions allergiques, qui peuvent conduire à un choc anaphylactique dans les cas graves. Pour cette raison, les personnes allergiques au lait doivent absolument éviter la consommation de lait ou d'aliments contenant du lait. En particulier, le risque de protéines cachés de lait dans les aliments comme les saucisses, biscuits, plats préparés ou les boissons représentent un grave problème pour les personnes allergiques au lait. Pour cette raison, des systèmes de détection extrêmement sensibles sont donc nécessaires.

Principe du Test

Test immunologique à flux latéral de détection rapide du lait dans les aliments, les eaux de rinçage et les échantillons de surface (contrôles environnementaux). L'échantillon extrait est transféré dans un tube d'incubation, contenant des anticorps spécifiques prêt-à-l'emploi. Si l'échantillon contient du lait, un complexe antigène-anticorps va se former. Il sera ainsi mis en évidence avec la bandelette. Le test est facile d'utilisation, rapide et fiable.

Précautions

1. Le produit doit être conservé dans son emballage d'origine, entre 15 et 25°C. Ne pas utiliser après la date d'utilisation indiquée sur l'étiquette du kit. Ne pas ouvrir le produit avant usage.
2. Les bandelettes et les tubes d'incubation doivent être conservés dans leur emballage d'origine, fermé le plus hermétiquement possible. Ne pas congeler.
3. Suivre les instructions d'utilisation du test.
4. Les composants du test ont subi un contrôle qualité, selon une procédure standard propre à chaque lot. Ne pas mélanger les composants provenant de numéros de lots différents.

Echantillonnage:

Il doit être pris en considération que l'aliment testé puisse contenir une distribution non homogène du lait (contamination locale). Il est donc important de tester un échantillon représentatif de l'aliment, dans la mesure où seulement une petite quantité d'échantillon est analysée avec le test AgraStrip® Milk.

Detection:

La limite de détection du kit AgraStrip® Milk est de quelques ppm, mais varie en fonction de la matrice alimentaire testée. Pour fournir des résultats fiables, chaque matrice individuelle doit être validée avant d'utiliser ce test en routine. Pour de plus amples informations, veuillez contacter Romer Labs.

Attention:

Les échantillons de chocolat et de farine peuvent bloquer le compte-goutte du tube d'extraction. Ceci peut être évité en transférant directement l'extrait du tube d'extraction au flacon de réaction, à l'aide d'une pipette ou manuellement, en ajustant au niveau de graduation situé à 0,5 ml du tube de réaction.

Pour plus de renseignements, merci de contacter:

Distribué par :

Z.A de Gesvrine - 4 rue Képler - B.P.4125
44241 La Chapelle-sur-Erdre Cedex - France
t. : +33 (0)2 40 93 53 53 | f. : +33 (0)2 40 93 41 00
commercial@humeau.com



w w w . h u m e a u . c o m

Garantie

L'utilisateur assume tous les risques en utilisant les produits et services de Romer Labs UK Ltd. Romer Labs UK Ltd garantit que ses produits et services remplissent l'ensemble des standards de contrôle qualité assignés par Romer Labs UK Ltd, et, Romer Labs UK Ltd, à son gré, réparera ou remplacera tout produit, composant, ou service récurrent qui s'avèrera être défectueux de par sa production ou en qualité pendant une période spécifique pour chaque produit ou avant sa date limite de consommation, et que notre contrôle déclarera défectueux en soi. Cette garantie réfute toute autre garantie, implicite ou explicite, y compris mais sans limitation, les garanties de qualité, de valeur marchande et d'adaptation à un usage quelconque, de productivité, ou tout autre problème. En aucun cas Romer Labs UK Ltd ne pourra être tenu comme responsable dans le cadre d'une mauvaise utilisation de ses produits. Romer Labs UK Ltd par la présente, décline tout autre recours, responsabilités, garanties ou engagements, expresse ou tacite, découlant de la loi ou d'autres sources, et ne pourra être tenu comme responsable pour toutes pertes de bénéfices ou dommages, directs, indirects ou accidentels, à une personne ou un bien, relative à l'utilisation de ses produits ou services. Cette garantie ne couvre pas toutes modifications, ou autre changement, à l'exception d'un écrit signé par une personne compétente représentant Romer Labs UK Ltd.

POUR LES NOTES

POUR LES NOTES